

# PM-CARE® 3V-BALLOON

## CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE 3 VOIES MALLÉABLE AVEC BALLON

21



Le cathéter pour hystero 3 voies malléable avec ballon **PM-CARE® 3V-BALLOON** permet de réaliser des hystérogaphies et des hystérosonographies. Ce cathéter malléable peut être courbé et mis en forme pour s'adapter à l'anatomie de la patiente.

### ATOUTS


- Manipulation aisée et simple.
- Etanchéité assurée grâce aux performances du ballonnet en silicone.
- Connecteur standard permettant de brancher une seringue pour l'injection du produit.
- Insertion atraumatique.

### RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre du cathéter (mm / Fr)	Diamètre du ballonnet gonflé (mm)	Ballonnet insufflation maxi de gaz (cc)	Longueur (mm)
PS3310733	2,66 / 8	13	2,5	230

### INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 <sup>re</sup> mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 5 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

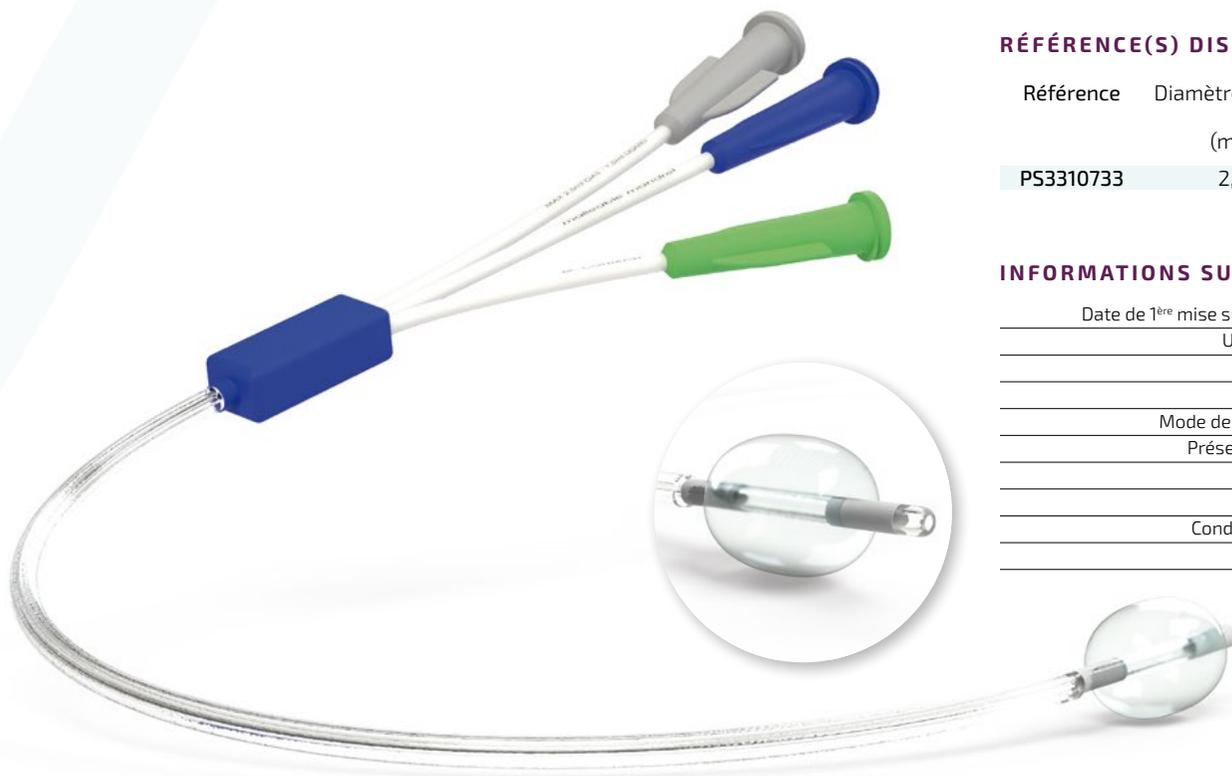

PRINCE MEDICAL SAS  
 ZA La Sente Du Moulin  
 64 rue Gutenberg - 60530 Erceuis - France  
[www.prince-medical.com](http://www.prince-medical.com)  
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
[prince-medical@omerin.com](mailto:prince-medical@omerin.com)

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL  
 DEVICES