

CLEANBRUSH® ENDO


BROSSE DE NETTOYAGE POUR CANAL OPÉRATEUR D'ENDOSCOPES



Les brosses de nettoyage CLEANBRUSH® ENDO sont destinées au nettoyage


- des canaux opérateurs, canaux air/eau des endoscopes flexibles,
- des canaux opérateurs, canaux air/eau des endoscopes rigides,
- de l'érecteur de duodénoscope type O.

Elles sont adaptées aux principaux gastrosopes, coloscopes, duodénoscopes, enteroscopes, bronchosopes, cystoscopes, urétérosopes, néphrosopes, hystérosopes et naso-laryngoscopes du marché.

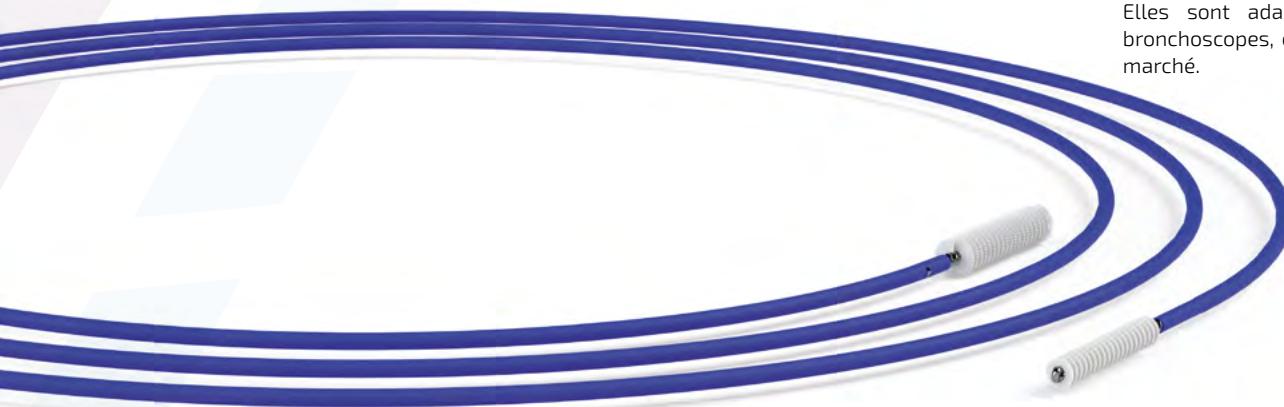

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	1999
Usage unique	Oui
Classe	I
Stérile	Non (décontamination à l'oxyde d'éthylène)
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 50 unités en emballage non-stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

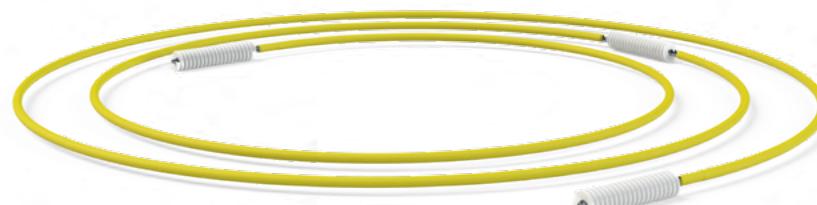

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.
® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

> NETTOYAGE DU CANAL OPÉRATEUR D'ENDOSCOPES FLEXIBLES

Référence	Diamètre Brosse (mm)	Nombre de brosse(s)	Diamètre gaine (mm)	Diamètre conseillé du canal opérateur de l'endoscope	Longueur (cm)
HN3272011	2	1	0,8	De 1 mm à 1,6 mm	110
HN3272023	2	1	0,8	De 1 mm à 1,6 mm	230
HN1050106	1,8	1	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	60
HN1050110	1,8	1	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	100
HN1050123	1,8	1	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	230
HN1050135	1,8	1	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	350
HN1050138	1,8	1	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	380
HN1060110	1,8	2	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	100
HN1060123	1,8	2	1	De 1,2 mm à 1,6 mm	230
HN1053006	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	60
HN1053007	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	75
HN1053010	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	100
HN1053018	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	180
HN1053023	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	230
HN1053028	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	280
HN1063010	3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	100
HN1063018	3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	180
HN1063023	3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	230
HN1063028	3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	280
HN2083018	11 & 3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	180
HN2083023	11 & 3	2	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	230
HN1055002	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	20
HN1055006	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	60

> NETTOYAGE DU CANAL OPÉRATEUR D'ENDOSCOPES RIGIDES

Référence	Diamètre Brosse (mm)	Nombre de brosse(s)	Diamètre gaine (mm)	Diamètre conseillé du canal opérateur de l'endoscope	Longueur (cm)
HN1053004	3	1	1,60	De 1,8 mm à 2,6 mm	40
HN1055004	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	40
HN1051104	11	1	1,80	De 6,1 mm à 10,6 mm	40

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

Référence	Diamètre Brosse (mm)	Nombre de brosse(s)	Diamètre gaine (mm)	Diamètre conseillé du canal opérateur de l'endoscope	Longueur (cm)
HN1055010	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	100
HN1055018	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	180
HN1055020	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	200
HN1055023	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	230
HN1055028	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	280
HN1055030	5	1	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	300
HN1065010	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	100
HN1065018	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	180
HN1065020	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	200
HN1065023	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	230
HN1065028	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	280
HN1065030	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	300
HN2085023	11 & 5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	230
HN1785023	5	3	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	230
HN3525023	5	2	1,80	De 2,7 mm à 4,6 mm	230
HN1056506	6,5	1	1,80	De 4,7 mm à 6 mm	60
HN1056523	6,5	1	1,80	De 4,7 mm à 6 mm	230
HN1066523	6,5	2	1,80	De 4,7 mm à 6 mm	230
HN1068023	8	2	1,80	De 4,2 mm à 7,6 mm	230
HN1068028	8	2	1,80	De 4,2 mm à 7,6 mm	280

> AUTRES NETTOYAGES

Référence	Diamètre Brosse (mm)	Nombre de brosse(s)	Type de nettoyage	Longueur (cm)
HN4302000	2	1	Erecteur duodénoscope type 0	6



PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com